

本试剂盒仅供研究使用, 不可用于诊断!

Research use only, not for diagnostic use!

## 人 Myeloperoxidase/MPO ELISA 检测试剂盒使用手册 Myeloperoxidase/MPO (Human) ELISA Kit User Manual

---

---

<b>Catalog No.</b>	<b>RGH824-1</b>
<b>储存/Store at</b>	<b>2~8℃,标准品保存于-20℃, 避光</b>
<b>灵敏度/Sensitivity</b>	<b>28.72 pg/mL</b>
<b>测定范围/Range</b>	<b>62.5-4000 pg/mL</b>

---



**注意: 使用前请阅读安全数据表(SDS) 并按照指示, 穿戴实验服、防护眼镜和手套操作!**

---

## 产品描述

本产品为人MPO 酶联免疫吸附定量检测试剂盒。

### MPO 介绍

髓过氧化物酶(MPO)是一种过氧化物酶, 在人类中由位于17号染色体上的MPO基因编码。它是一种存在于中性粒细胞的嗜苯胺蓝颗粒中的溶酶体蛋白, 在脱颗粒过程中释放到细胞外空间。MPO在中性粒细胞中表达最丰富, 可产生具有抗菌活性的次卤酸。MPO有血红素色素, 导致中性粒细胞中的分泌物呈现绿色, 如脓。另外, MPO介导蛋白质亚硝基化、3-氯酪氨酸形成及二酪氨酸交联。MPO缺乏症是一种导致机体免疫缺陷的遗传性疾病。MPO水平的升高会大大加倍增加心血管死亡的风险。也有人认为, MPO在动脉粥样硬化病变发展中、致使斑块不稳定中起着重要作用。

## 试剂盒原理

本试剂盒采用夹心法酶联免疫分析技术。



图1. 预包被MPO抗体微孔板

孔板上预包被了抗人MPO特异性抗体。

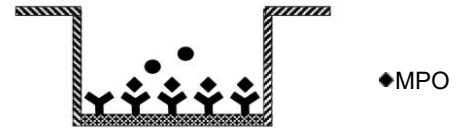


图2. MPO被抗体捕获

样品或标准品中的人MPO与包被在微孔中的抗体结合。



图3. 加入生物素化MPO检测抗体

加入生物素偶联的抗人MPO抗体, 该抗体与第一抗体捕获的人MPO结合。



图4. 加入链霉亲和素-HRP

孵育后, 洗去未结合的生物素偶联的抗人MPO抗体。加入链霉亲和素-HRP。



图5. 催化底物形成有颜色产物

加入底物, 经过HRP催化形成有色产物, 产物吸光值与样品或标准品中存在的人MPO的量成比例。通过加入酸终止反应, 并在450 nm处测量吸光值

## 试剂

### 人MPO ELISA试剂盒(48次检测)

- 预包被抗人MPO单克隆抗体的微孔板(6条, 每条8个孔) × 1块
- 冻干人MPO标准品 × 1管
- 100 x 生物素偶联抗人MPO检测抗体 × 1管
- 100 x 链霉亲和素-HRP × 1管
- 10 x 检测缓冲液 × 1管
- 20×清洗缓冲液 × 1瓶
- 1×TMB底物 × 1瓶
- 1×终止液 × 1瓶
- 封板膜 × 3张

## 试剂盒贮存

- 将试剂盒试剂储存在2至8℃之间, 将冻干标准品储存在-20℃以下。
- 使用后, 剩余试剂应立即放回冰箱。
- 请在标签上注明的试剂盒和试剂的有效期内使用。试剂盒只有在正确储存条件下, 才能保证试剂盒成分的有效期。
- 重复使用时避免试剂之间交叉污染。试剂间的污染会造成试剂盒失效。

## 适用样本与样本处理

- 该试剂盒适用于细胞培养上清、血清、血浆等样本的分析。分析其他生物样品时需对分析方法进行优化。
- 对于血液样本, 应当尽快将血清或血浆分离。样品中出现沉淀时, 需先将沉淀分离后再行分析。避免使用严重溶血或血脂异常的样本。
- 大量的样本应先分装后, 置于-20℃下冷冻保存, 以避免人MPO的活性损失。如果样品在24小时内分析, 可先储存在2~8℃。样品应避免反复冻融。冷冻样品分析前, 应缓慢升至室温, 并轻轻混合。禁止在37℃的水浴中解冻样品。请勿涡旋或剧烈搅动样品。

## 需准备的材料

- 刻度移液管(5毫升和10毫升)
- 5μL至1000μL可调单通道微量移液器
- 50μL至300μL可调多通道微量移液器
- 一次性吸头
- 一次性样品槽

- 配制试剂所需的烧杯、烧瓶、量筒等
- 自动洗板机
- 多波长酶标仪(450nm)
- 37℃恒温箱
- 超纯水
- 带有回归分析程序的统计计算机

## 注意事项

- 所有化学品都应被视为具有潜在危险。建议仅由接受过实验室技术培训的人员操作使用本产品, 并按遵循良好实验室规范的原则。使用时需穿戴合适的防护服, 佩戴好安全眼镜和手套。应注意避免试剂接触到皮肤或眼睛。如果接触到, 立即用大量水冲洗。具体建议见材料安全数据表(SDS)和/或安全声明。
- 试剂仅供研究使用, 不得用于诊断或治疗。
- 请勿将其他批次或其他来源的试剂混合使用或替换。
- 请勿使用标签上过期的试剂盒试剂。
- 在储存或孵育过程中, 请勿将试剂盒试剂暴露在强光下。
- 取用试剂时, 禁止用嘴吸取移液管。
- 请勿在处理试剂盒试剂或样本的区域进食或吸烟。
- 处理试剂盒试剂或样本时, 应佩戴橡胶或一次性乳胶手套。避免皮肤或粘膜接触试剂盒试剂或样本。
- 避免底物溶液与氧化剂和金属接触。
- 避免飞溅或产生气溶胶。
- 为避免微生物、试剂或样本的交叉污染而导致测试无效, 请使用一次性移液器吸头和/或移液器。
- 使用洁净的专用试剂容器分装结合物和底物试剂。暴露在酸中会使结合物失活。
- 试剂稀释和配制需用蒸馏水或纯水。
- 底物溶液使用前必须恢复至室温。
- 被污染的材料或疑似粘有传染性病原体的样本需进行净化处理后再行丢弃。首选方法是121℃下灭菌至少1小时。
- 不含酸的液体废物和中和废物可用1.0%次氯酸钠处理30分钟后排放。酸性液体废物在添加次氯酸钠之前必须先中和。

## 试剂配制

- 浓缩缓冲液稀释前需恢复至室温。
- 如果浓缩缓冲液中有结晶, 可以预热至结晶溶解后再稀释, 结晶不影响试剂盒性能。

### 1×清洗缓冲液:

- 将20×浓缩清洗缓冲液(25mL)全部倒入干净的容器中。用蒸馏水或纯化水定容至500 mL。也可以根据使用量, 配制所需体积的清洗缓冲液。
- 轻轻搅拌以避免产生泡沫。
- 清洗缓冲液需储存在2~25℃。



**清洗缓冲液配制后在3天内使用, 过期可能会影响实验结果!**

### 1×检测缓冲液:

用蒸馏水以1:10的比例稀释浓缩的检测缓冲液。



**1×检测缓冲液配制后需在3天内使用, 过期可能会影响实验结果!**

### 1×生物素偶联抗人MPO检测抗体:

用1×检测缓冲液以1:100的比例稀释浓缩的生物素偶联抗人MPO检测抗体。



**检测抗体稀释后需在30min内使用, 请勿使用过期产品!**

### 1×链霉亲和素-HRP:

用1×检测缓冲液以1:100的比例稀释浓缩的链霉亲和素-HRP。



**链霉亲和素-HRP稀释后需在30min内使用, 请勿使用过期产品!**

### 冻干人MPO标准品:

- 开盖前短暂离心, 用蒸馏水重溶标准品, 重溶体积标注于标准品标签上。静置15分钟, 待其充分溶解后, 轻轻混匀, 以确保干粉完全溶解, 复溶后标准品的浓度为8000pg/mL。
- 复溶后的标准品一次性使用, 请勿将剩余的标准品重复使用。
- 对于血清/血浆样本标准品制备, 用1×检测缓冲液直接在微孔板或其他干净的样品管中稀释。对于细胞培养上清的标准品制备, 用细胞培养基直接在微孔板或其他干净的样品管中稀释。
- 标准品稀释方法:
  - 1) 取7个干净样品管, 分别标记为: S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7。
  - 2) 在样品管S1~S7中分别加入225μL 1×检测缓冲液 (血清/血浆样本) 或细胞培养基 (细胞培养上清样本)。

- 3) 在S1管中加入225μL复溶标准液 (S1浓度=4000 pg/mL), 轻轻混匀。
- 4) 从S1管中取225μL移至S2管中, 混合均匀。
- 5) 重复上述操作, 连续稀释至S7管。以此创建标准曲线(见图6)。
- 6) 以1×检测缓冲液/细胞培养基作为空白对照。

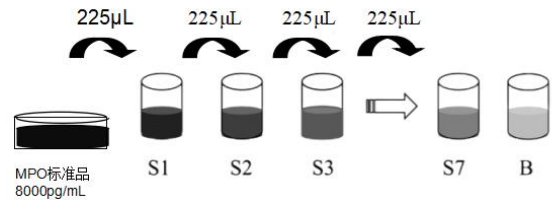


图6. MPO标准品梯度稀释示意图

## 试剂盒操作流程

- 根据待测样品的数量、标准曲线和空白对照等确定测试所需孔条的数量。为确保数据可信度, 每个待测点至少需要两个重复孔。从孔条支架上取下额外的微孔条, 并将其装回铝箔袋中, 重新放置2~8°C下储存。
- 用350  $\mu\text{L}$ 的清洗缓冲液洗涤微孔条每个孔至少2次, 每次洗涤完, 彻底吸出微孔中残留物。保持清洗缓冲液在孔中停留约10~15秒。不要刮伤微孔的表面。完成最后一个清洗步骤后, 吸干孔内残留, 并在吸水垫或纸巾上轻敲微孔条以去除多余的清洗缓冲液。清洗后立即使用微孔板条, 或者将微孔条倒置在湿吸水纸上不超过15分钟, 以免微孔干燥。
- 按照表1, 依次加入100 $\mu\text{L}$ 不同浓度梯度的标准品。检测血清/血浆样本加入100 $\mu\text{L}$ 1 $\times$ 检测缓冲液作为空白对照, 检测细胞上清样本则加入100 $\mu\text{L}$ 细胞培养基作为空白对照。
- 血清/血浆: 在待测样本孔加入100 $\mu\text{L}$ 预稀释样本 (推荐2000倍稀释。第一步, 10 $\mu\text{L}$ 样本+390  $\mu\text{L}$ 1 $\times$ 检测缓冲液。第二步, 10 $\mu\text{L}$ 第一步稀释的混合样本+490 $\mu\text{L}$ 1 $\times$ 检测缓冲液)。  
细胞培养上清: 在待测样品孔中加入100 $\mu\text{L}$ 细胞培养上清。
- 向所有孔中加入50 $\mu\text{L}$  1 $\times$ 检测抗体。
- 用封板膜覆盖后, 100-300 转/分钟振荡 (保证每孔溶液不撒出且能充分混匀即可), 室温 (25°C $\pm$ 3°C) 避光孵育120分钟。
- 去除液体, 用350 $\mu\text{L}$ 清洗缓冲液洗板6次。
- 向所有孔中添加100 $\mu\text{L}$  1 $\times$ 链霉亲和素-HRP。
- 封板后, 100-300 转/分钟振荡 (保证每孔溶液不撒出且能充分混匀即可) 室温 (25°C $\pm$ 3°C) 避光孵育45分钟。
- 去除液体, 用350 $\mu\text{L}$ 清洗缓冲液洗板6次。
- 向所有孔中添加100 $\mu\text{L}$  TMB底物溶液。室温 (25°C $\pm$ 3°C) 避光孵育5-30分钟。当最高浓度标准样品已显深蓝色时, 立即终止显色。也通过测定最高浓度标准样品在 620nm下的吸光值, 当达到0.9~0.95时, 立即终止反应。
- 向每个孔中迅速加入100 $\mu\text{L}$ 终止液。并尽快读取显色结果 (3min 内)。
- 选择主波长450nm(任选610~650nm作为参考波长), 测定每个微孔的吸光值。

表1. 样品、标准品加样示例

	1	2	3	4
A	标准品A1 4000pg/mL	标准品A1 4000pg/mL	样品A	样品A
B	标准品B1 2000pg/mL	标准品B1 2000pg/mL	样品B	样品B
C	标准品C1 1000pg/mL	标准品C1 1000pg/mL	样品C	样品C
D	标准品D1 500pg/mL	标准品D1 500pg/mL	样品D	样品D
E	标准品E1 250pg/mL	标准品E1 250pg/mL	样品E	样品E
F	标准品F1 125pg/mL	标准品F1 125pg/mL	样品F	样品F
G	标准品G1 62.5pg/mL	标准品G1 62.5pg/mL	样品G	样品G
H	空白	空白	样品H	样品H

- 血清/血浆: 在待测样本孔加入100 $\mu\text{L}$ 预稀释样本 (推荐2000倍稀释。第一步, 10 $\mu\text{L}$ 样本+390  $\mu\text{L}$ 1 $\times$ 检测缓冲液。第二步, 10 $\mu\text{L}$ 第一步稀释的混合样本+490 $\mu\text{L}$ 1 $\times$ 检测缓冲液)。  
细胞培养上清: 在待测样品孔中加入100 $\mu\text{L}$ 细胞培养上清。
- 向所有孔中加入50 $\mu\text{L}$  1 $\times$ 检测抗体。
- 用封板膜覆盖后, 100-300 转/分钟振荡 (保证每孔溶液不撒出且能充分混匀即可), 室温 (25°C $\pm$ 3°C) 避光孵育120分钟。

## 数据处理与分析

- 计算每组标准品和样品的平均吸光值, 偏差应 $\leq$  20%。以人MPO浓度为横坐标、标准品的平均吸光值为纵坐标, 绘制标准曲线。建议使用4或5参数、多项式、log-log等曲线拟合方法绘制最佳拟合曲线。
- 通过样品的平均吸光值, 确定待测样品中MPO的浓度。
- 当计算的浓度超过线性范围内的最大值时, 样本需要进一步稀释, 以便精确定量。
- 典型的标准曲线如图7所示。因操作条件的不同, 每次进行实验时, 应当重新绘制标准曲线。确保结果准确。

标准曲线的吸光值可能因分析条件差别而异(例如, 操作员、移液偏差、清洗效果或温度等条件影响)。此外, 试剂盒的保存期可能影响酶活性, 从而影响显色效果。显色效果差异一般不影响实验结果。

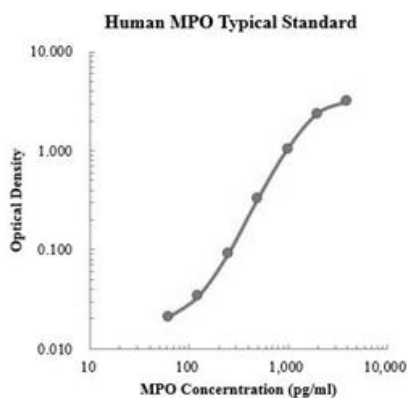


图7. 典型人MPO ELISA的标准曲线

## 限制因素

- 由于样品分析因检测条件而异, 因此每次运行都必须建立新标准曲线。
- 样本或试剂因生物污染或试剂之间的交叉污染可能会导致错误的结果。
- 尽量采用干净一次性移液器吸头、容器等, 对于可重复使用的玻璃器皿, 必须在清洁后使用, 并彻底冲洗掉所有清洁剂。
- 不适当或不充分的清洗将导致假阳性或假阴性结果。
- 在任何新的清洗流程之前需完全吸干残余的溶液, 按照每个步骤要求进行清洗, 不要让孔长时间敞开或干燥。

## 试剂盒性能

### 灵敏度

本试剂盒对人MPO的灵敏度为**28.72pg/mL**。

### 重现性

- 批内分析

通过已知浓度的3个样品, 同一块板上测定20次评估批内差异, 分析结果(见表3)。总批内变异系数**5.3%**。

- 批间分析

通过已知浓度的3个样品, 经过2个以上批次的试剂盒, 且经过3个不同实验员的测定20次评估批间差异, 分析结果(见表3)。总批间变异系数为**5.7%**。

**表3. 试剂盒批内与批间分析**

样品编号	批内分析			批间分析		
	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.3
测定次数	20	20	20	20	20	20
浓度均(pg/ml)	301.9	1726.2	3175.1	280.2	1239.8	2826.3
C.V(%)	5.7	5.0	4.9	6.6	5.6	4.5

### 加标回收

通过将3个浓度的人MPO掺入正常血清样品来评估回收率。在3个独立的实验中进行测定, 每个实验重复8次。在这些实验中, 以未加标血清用作空白。总平均回收率为**101%**。注意: 回收率差异取决于所用的血清。

### 稀释平行性

不同浓度人MPO的三个血清样品以4个连续梯度的2倍稀释(1:2-1:16), 每个重复4次, 总平均回收率为**96%**。注意: 回收率取决于所用的血清。

### 特异性

通过将正常生理浓度的干扰因子掺入人MPO阳性血清中, 来评估因子的干扰。未检测到交叉反应。